TECHNIKA Biuro Wyceny Ruchomości Kamil Kałuża
Aleja Grunwaldzka 14/59, 98-200 Sieradz
tel. 792-220-502 mail: biuro@technikawyceny.pl Numer wyceny: PEKAO/120/2025

OPIS Z WYCENY

Zestaw urządzeń medycznych

Numery seryjne: zgodnie z zestawieniem

Numer umowy leasingowej: 39/0477/18



Autor wyceny: Kamil Kałuża

Sieradz, 16.08.2025 r.

01. ZAMAWIAJĄCY WYCENĘ
Pekao Leasing Sp. z o.o., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

02. WŁADAJĄCY
Pekao Leasing Sp. z o.o., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

03. PRZEDMIOT WYCENY
Zestaw urządzeń medycznych

04. DATA I MIEJSCE OGLĘDZIN
Przedmiotowy środek techniczny poddano oględzinom w dniu 04.08.2025 r., na terenie hali magazynowej firmy Famat, w miejscowości Ostrowiec 1A, w obecności pracownika magazynu.

05. INFORMACJE DODATKOWE
Komorę kriogeniczną okazano w stanie uniemożliwiającym sprawdzenie działania w warunkach magazynowych – zdemontowana na podzespoły.
Pozostałe urządzenia okazano w warunkach magazynowych, podłączone do zasilania, z możliwością uruchomienia, lecz bez możliwości sprawdzenia działania.

06. PROCEDURA SZACOWANIA WARTOŚCI

6.1. Skrócony opis techniczny oraz podstawowe dane znamionowe:

Przedmioty wyceny stanowią wyposażenie medyczne. Poszczególne elementy wyposażenia znajdują zastosowanie w gabinetach lekarskich oraz placówkach medycznych. Na tabliczkach i obudowach urządzeń widnieje oznakowanie CE.

Szczegółowe zestawienie urządzeń ich cech identyfikacyjnych i podstawowych danych znamionowych:

L.p.	Nazwa urządzenia	Numer seryjny	Rok produkcji	Dane techniczne	Uwagi
1	Elektrostymulator BODY ActiWave	AC-H-17-0480	Brak danych	Ekran dotykowy: 15” Liczba kanałów: 12 Wyposażenie: - kamizelki 5 szt. (rozmiary: XXS,S, S, M, M) - przewód zasilający,	Typowe ślady użytkowania – zarysowania, zabrudzenia. Urządzenie podłączono do zasilania – urządzenie uruchomiło się, nie reaguje na sterowanie. Konieczna weryfikacja. Braki: konektor, Stan – przeciętny.
2	Tester wydolności COSMED K5	2018010445	Brak danych	Wymiary: 174x64x114 mm Wyposażenie: - walizka transportowa, - karta SD - zestaw masek, - ładowarka - akumulatory 2 szt.	Typowe ślady użytkowania – zarysowania, zabrudzenia. Urządzenie uruchomiło się, dokonano przejścia przez menu. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Stan – dostateczny.
3	Urządzenie do monitorowania wydolności serca CARDIOSCAN CS-3	045171310	2017	Wyposażenie: -Systems Calorie Fit, nr seryjny: CF2017-00553,	Typowe ślady użytkowania – zarysowania, zabrudzenia.

				- BIA PAD PS-1, nr seryjny: 20175383, - Cardioscan Checkpoint Terminal M16, nr seryjny: TM16207,	Urządzenie podłączono do zasilania – urządzenie uruchomiło się, nie reaguje na sterowanie. Konieczna weryfikacja. Braki: konektor, Stan – przeciętny.
4	Analizator składu ciała InBody 770	181700022	2017	Waga: 38 kg Wymiary: 526x850x1175 mm Pamięć: 100 000 pomiarów Częstotliwość: 1, 5, 50, 250, 500, 1000 kHz Czas testu: 60 s Zakres obciążenia: 10-270 kg	Typowe ślady użytkowania – zarysowania, zabrudzenia. Urządzenie podłączono do zasilania – urządzenie uruchomiło się, nie reaguje na sterowanie. Konieczna weryfikacja. Stan – przeciętny.
5	Komora kriogeniczna JUKA Kriokomora 2005	01487	2018	Zakres temperatur: -100 - -160°C Zasilanie: 230V Moc znamionowa: 3500 W Masa: 2000 kg	Komora zdemontowana na części, brak możliwości weryfikacji kompletności i sprawności. Konieczna weryfikacja serwisowa. Stan – przeciętny.

6.3. Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji

Urządzenia znajdują się w hali magazynowej, są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Władający przedstawił fakturę zakupową, protokół odbioru przedmiotu. Brak instrukcji obsługi poszczególnych podzespołów oraz specyfikacji. Zgodnie z dokumentami zakupowymi przedmioty zakupione przez Władającego w dniu 24.09.2018 r. jako nowe. Na tabliczkach znamionowych jest oznakowanie CE. Przedmioty ze śladami użytkowania. Przedmioty zmagazynowane w hali, w dobrych warunkach. Szczegółowe uwagi przy opisie poszczególnych urządzeń.
Ogólny stan techniczny przedmiotów oceniam jako dostateczny.

07. ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
2. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
3. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
4. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
5. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych obiektu (nr seryjny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych źródeł.
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Opracował:
Kamil Kałuża

Sieradz, 16.08.2025 r.

Urządzenie nr 1: Elektrostymulator BODY ActiWave	
	
	


BODY ACTIWAVE
www.xbodyworld.com
Part: Head
Input: 12V⎓3A; 36W max.
S/N: AC-H-17-0480
XBody Hungary Kft.






BODY












Welcome
BODY
IS LOADING...
WWW.XBODYWORLD.COM
BODY


BODY
BODY


BODY ACTIWAVE
www.xbodyworld.com
Part: Stand
Input: 100-240VAC; 50/60Hz
Output: 12V⎓4.16A; 50W max.
Model: Standard
S/N: AC-S-18-0006
XBody Hungary Kft.




M


BODY
S


BODY
XXS







Zestaw nr 2: Tester wydolności COSMED K5






COSMED
REF C09090-01-99
S/N 2018010445
IP54


COSMED
K5
COSMED
K5


Test
Calibration
Settings
Utility
Home
COSMED
K5


27 Apr 2022 18:08
Archive status report
Registered subjects: 56
Archived tests: 73
Archive size: 8370 K
Uptime: 01:01:20
System information
HW Serial Number: 2018010445
Firmware information
Information
COSMED
K5


27 Apr 2022 18:08
Uptime: 01:01:20
System information
HW Serial Number: 2018010445
Firmware information
Build date: mer 14 giu 2017, 10.22.40, CEST
Version: 17
Hash: 3d0cb65e...d14b177e
Hardware information
Information
COSMED
K5


NB2037CM31 REV 1.2
Assembled in the USA
INSPIRED ENERGY
NB2037CM
2INR19/66
This battery meets the requirements of IEC62133:2002












WARNING
· DO NOT EXPOSE TO WATER
· FULLY ENGAGE BATTERY CONNECTOR
· ONLY USE RECOMMENDED POWER SUPPLY
· DO NOT COVER FAN OR OBSTRUCT AIRFLOW
· DO NOT OPEN
INSPIRED ENERGY
SOLUTIONS FOR PORTABLE POWER
For best results use Inspired Energy battery packs
To buy call US 1-855-5-INSPIRE (1-855-546-7747) or visit www.inspiredenergy.com
DIRECTIONS
TO CHARGE (All Models):
PLACE BATTERY INTO CHARGER BAY
LED Indicator
Status
GREEN FLASHING
CHARGING
GREEN SOLID
CHARGING COMPLETED
RED SOLID
BATTERY FAULT
TO CALIBRATE (CH9059 ONLY):
LED Indicator
Status
BLUE FLASHING
CALIBRATING
BLUE SOLID
CALIBRATION COMPLETED
RED FLASHING
REQUESTING CALIBRATION
(Press button to recalibrate)


COSMED
Dual Battery Charger














Zestaw nr 3: Urządzenie do monitorowania wydolności serca CARDIOSCAN CS-3






cardioscan

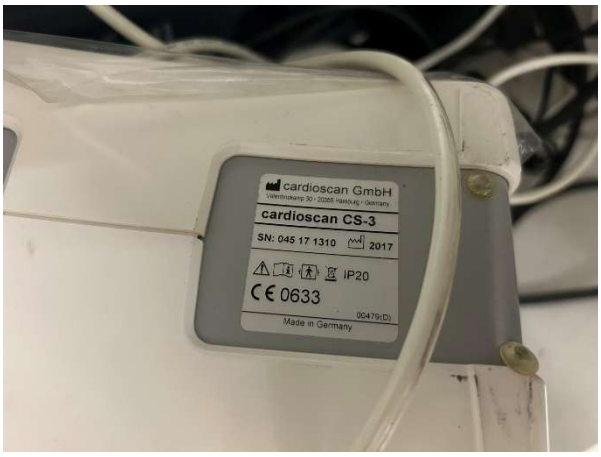
cardioscan GmbH
cardioscan CS-3
SN: 045 17 1310
2017
IP20
CE 0633
Made in Germany

















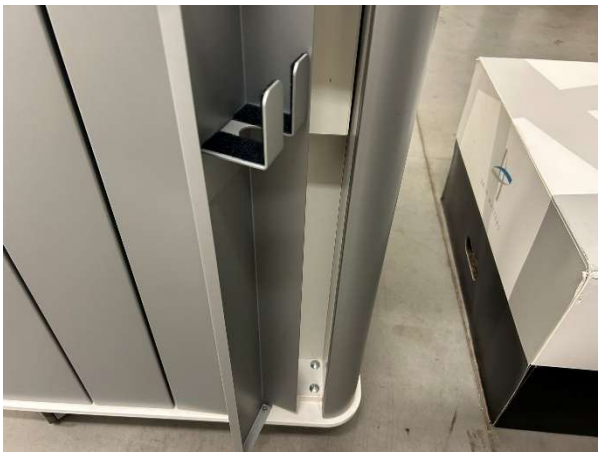




IN

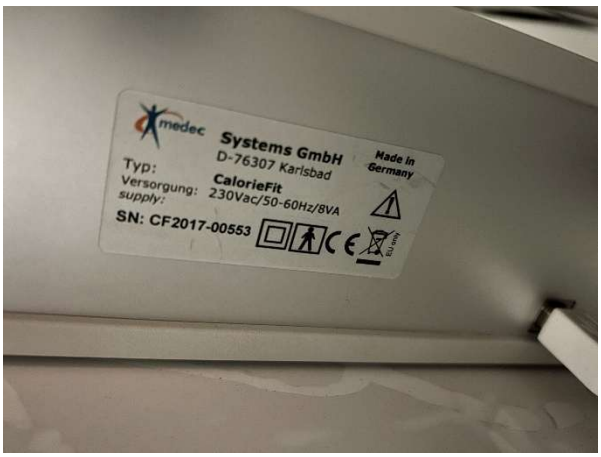
medec
Systems GmbH
D-76307 Karlsbad
Made in Germany
Typ:
CalorieFit
Versorgung:
supply:
230Vac/50-60Hz/8VA
SN: CF2017-00553


bodyscan


BIA-PAD Typ PS-1
Bioelektrisches Impedanz-Analyse-Gerät
SN 20176383
DC 5 V
2017
Kommunikation & Service GmbH
Berliner Chaussee 74 | 15234 Frankfurt (Oder)/Germany












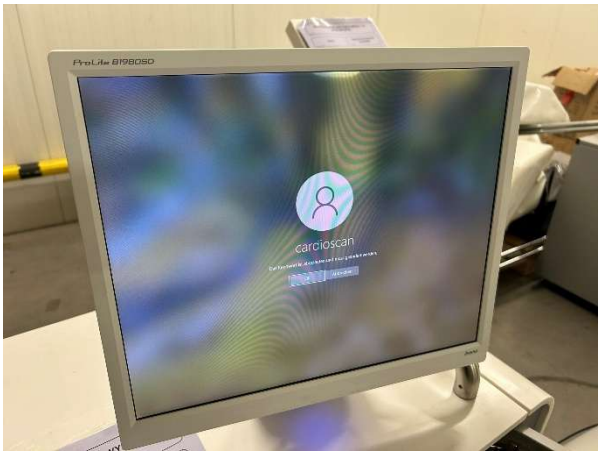



Zestaw nr 4: Analizator składu ciała InBody 770


cardioscan
InBody 770
ZAKAZ WEJŚCIA W BIUTACH


cardioscan
InBody 770
ZAKAZ WEJŚCIA W BIUTACH


InBody 770




InBody770
DANGER
CAUTION
InBody
MEDFITNESS MARIAC GYM
K.B.H. LESZCZYŃSCY


InBody


Enter



InBody
Enter


POMIAR TYLKO W OBECNOŚCI TRENERA




POMIAR TYLKO W OBECNOŚCI TRENERA


InBody
InBody
Enter

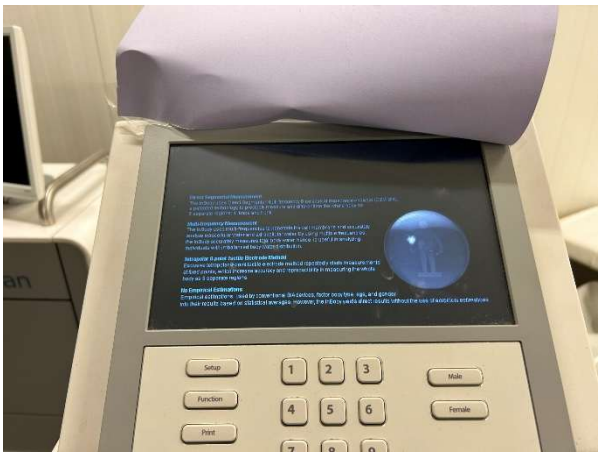



Zestaw nr 4: Komora kriogeniczna JUKA Kriokomora 2005












JUKA
JUKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
32-005 Niepołomice ul.Fabryczna 4, Polska
centr.+48 12/284-41-00 fax+48 12/284-41-10
sekretariat@juka.com.pl www.juka.com.pl
KOMORA KRIOGENICZNA
Typ: Kriokomora 2005
Model 0401
Numer fabryczny: 01487
Rok produkcji 2018
Zakres temp. [°C] -100 ÷ -160
REV 02_07.2015 Made in EU
Napięcie znamionowe 230V 50Hz
Moc znamionowa 3500 W
Masa 2000 kg
0197






2018
01487


KOMORA KRIOGENICZNA KRIOKOMORA 2005
MAGAZYN PEKAO LEASING
16922
2016
01487



POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO
PRZEPROWADZAĆ ZABIEGÓW SAMEMU SOBIE


MT8073iE
WEINTEK
S/N:1711105113

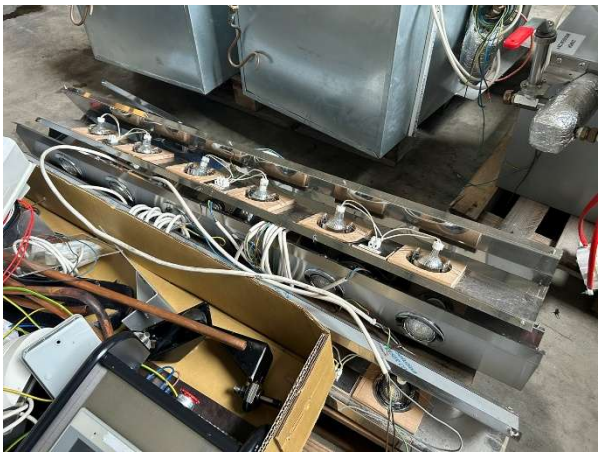

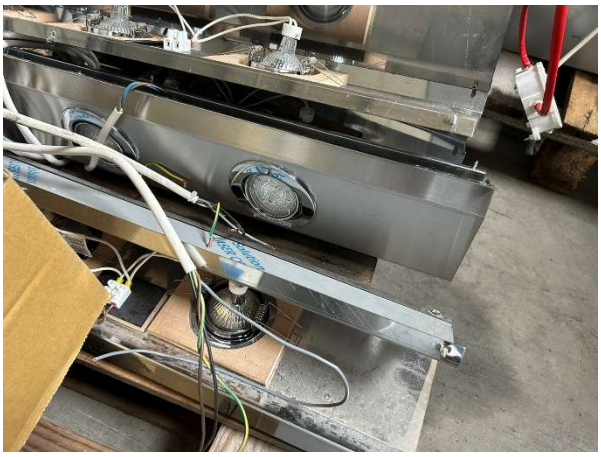



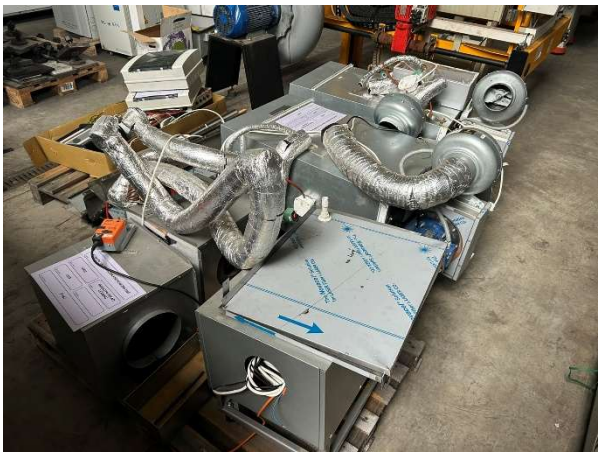






ZAWÓR
KRIOGENICZNY


UWAGA - NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM
gazex
ZAMONTOWANO MODUŁ Z SENSOREM GAZÓW
Typ: MS-P9E/N
MEDIUM KALIBRACYJNE
TLEN
ZAKRES POMIAROWY
25 %V/V
NASTĘPNA KALIBRACJA przed końcem: 09 /2025
gazex


BESEL S.A.
Silnik
Typ
Kl.izol.F
Praca S1
Cantoni











BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża
BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża
BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża
BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża
BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża
BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża
BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża
BOMIS
CERTYFIKAT
Kamil Kałuża